

عنوان کنترل : Universal I
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۷/۱۹

عنوان آزمایش : TSH
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹-


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۳۱۲	۰,۰۴۸	۱,۳۰۴	۱,۳۵۲	۱,۴	۱,۴۴۸	۱,۴۹۶	۱,۵۴۴	۱,۵۹۲

مقدار	تاریخ
۱,۴۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۵
۱,۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۱,۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۱,۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۱,۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۱,۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۱,۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۱,۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۴

CV%: 4.099	SD: 0.058	Mean: 1.416
------------	-----------	-------------

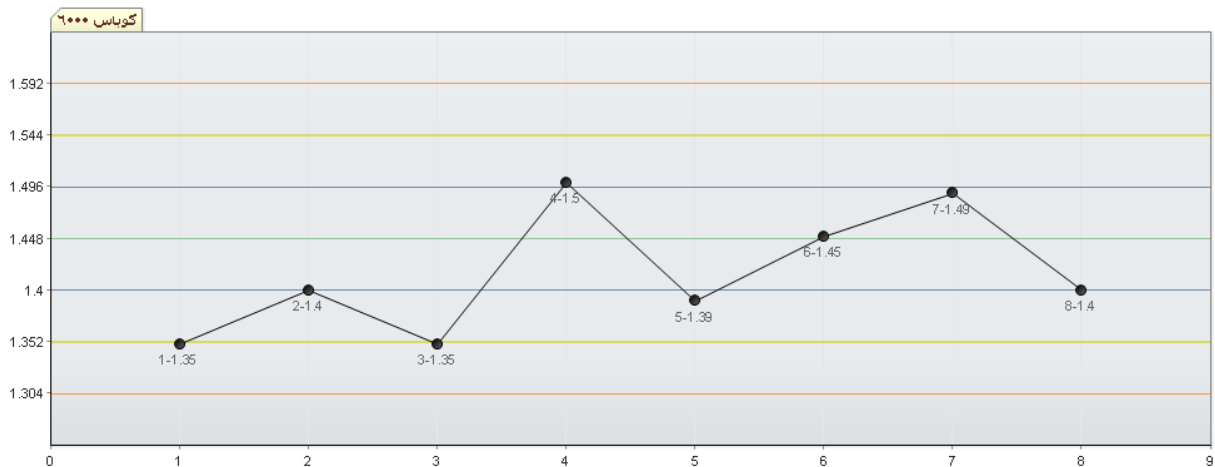

عنوان کنترل : Universal II
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۷/۱۹

عنوان آزمایش : TSH
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹-

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۰۶۴	۰,۲۸۲	۸,۳۵۹	۸,۶۴۱	۸,۹۲۳	۹,۲۰۵	۹,۴۸۷	۹,۷۶۹	۱۰,۰۵۱

مقدار	تاریخ
۹,۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۵
۹,۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۹,۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۸,۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۹,۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۸,۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۴

CV%: 3.287	SD: 0.302	Mean: 9.2
------------	-----------	-----------

