

universal I : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۳/۰۱


Testosterone : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹۰۵ /

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۲۲۶	۲۰,۴۱۷	۵۷۱,۷۱۶	۵۹۲,۱۳۳	۶۱۲,۵۵	۶۳۲,۹۶۷	۶۵۳,۳۸۴	۶۷۳,۸۰۱	۶۹۴,۲۱۸

مقدار	تاریخ
۶۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۶۷۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۵

مقدار	تاریخ
۶۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۶۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۳

CV%: 3.539	SD: 22.635	Mean: 639.5
------------	------------	-------------

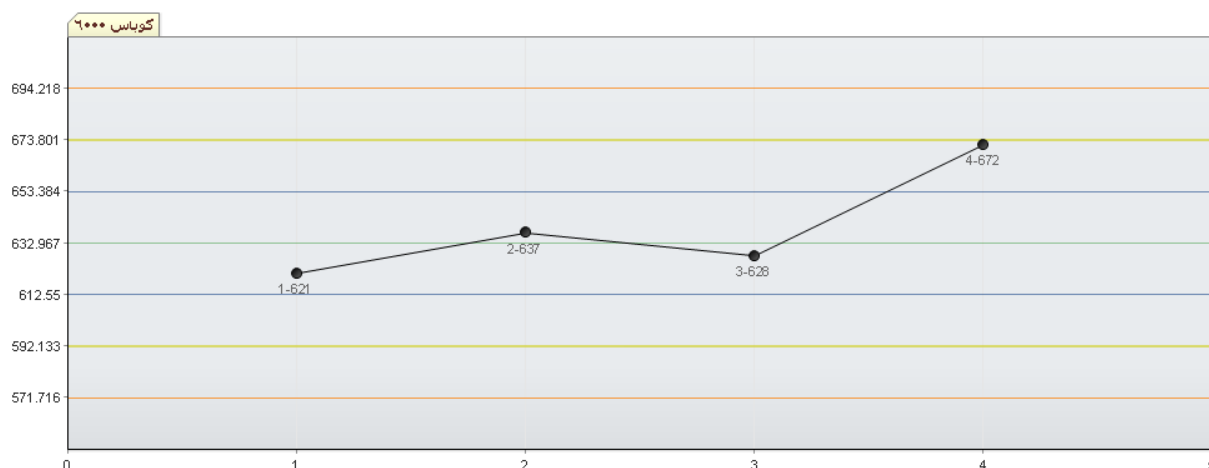

ABBOTT-3 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۰۶

سری ساخت : ۳۲۳۱۱۲۳۰

Testosterone : عنوان آزمایش :
ABBOT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۷	۵۴,۶۶۷	۶۵۷,۹۹۹	۷۱۲,۶۶۶	۷۶۷,۳۳۳	۸۲۲	۸۷۶,۶۶۷	۹۳۱,۳۳۴	۹۸۶,۰۰۱

مقدار	تاریخ
۸۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۷۹۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۸۷۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۷۸۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۷
۸۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۷۹۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۷۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۸۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۸۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۷۷۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۲

CV%: 4.874	SD: 39.466	Mean: 809.7
------------	------------	-------------

