

universal I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

Thyroglobulin : عنوان آزمایش :
COBAS 6000 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹۰۵


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۶۳۳	۰,۸۰۳	۱۹,۶۸۶	۲۰,۴۸۹	۲۱,۲۹۲	۲۲,۰۹۵	۲۲,۸۹۸	۲۳,۷۰۱	۲۴,۵۰۴

مقدار	تاریخ
۲۱,۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۲۲,۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۲۲,۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۲,۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۲۱,۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۲۰,۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۲۱,۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۲۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۲۳,۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۲۲,۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 3.781	SD: 0.832	Mean: 22
------------	-----------	----------

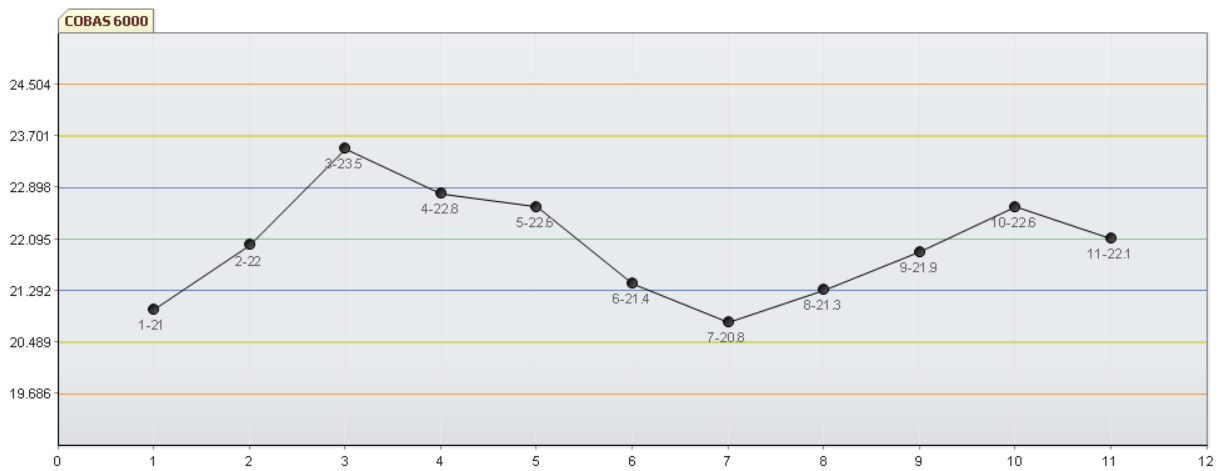

عنوان کنترل : universal II
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

عنوان آزمایش : Thyroglobulin
عنوان دستگاه : cobas 6000
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹۰۵

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۳۵۷	۲,۸۶۸	۷۶,۸۴۴	۷۹,۷۱۲	۸۲,۵۸	۸۵,۴۴۸	۸۸,۳۱۶	۹۱,۱۸۴	۹۴,۰۵۲

مقدار	تاریخ
۸۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۸۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۸۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۹۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۸۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۸۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۸۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۸۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۸۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۸۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۸۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 3.624	SD: 3.113	Mean: 85.909
------------	-----------	--------------

