

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

Triglycerides : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت: GP N025


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۹۵۲	۸,۲۷۷	۱۸۴,۶۰۹	۱۹۲,۸۸۶	۲۰۱,۱۶۳	۲۰۹,۴۴	۲۱۷,۷۱۷	۲۲۵,۹۹۴	۲۳۴,۲۷۱

مقدار	تاریخ
۱۹۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۲۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۸
۱۹۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۲۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۱۹۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۲۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۲۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۲۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۲۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۲۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۲۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۲۱۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۲۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۲۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۲۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۲۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۱۹۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۲۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 4.061	SD: 8.458	Mean: 208.263
------------	-----------	---------------

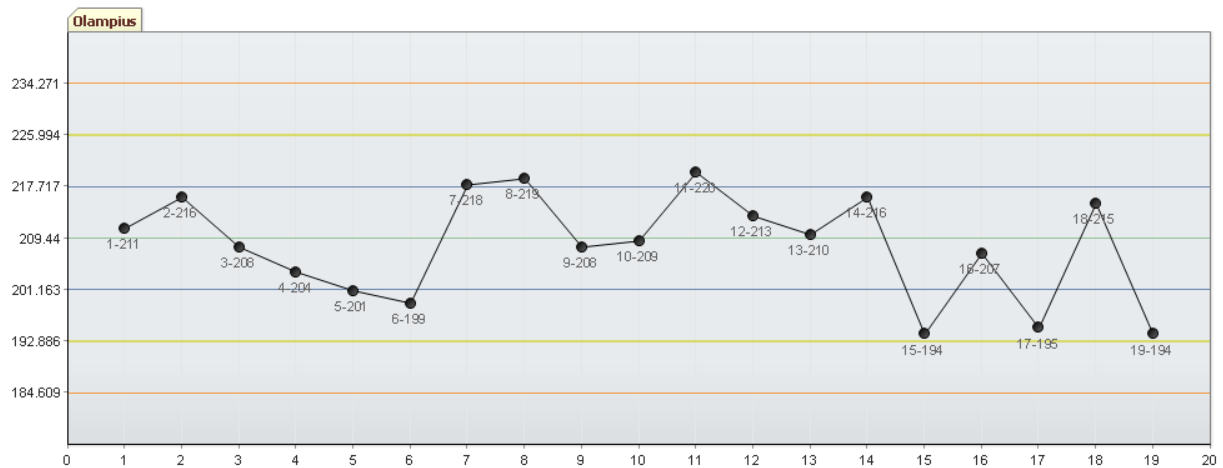

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

Triglycerides : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت: GN625

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۴۵۹	۳,۹۵۹	۱۰۲,۶۰۳	۱۰۶,۵۶۲	۱۱۰,۵۲۱	۱۱۴,۴۸	۱۱۸,۴۳۹	۱۲۲,۳۹۸	۱۲۶,۳۵۷

مقدار	تاریخ
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۸
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 2.471	SD: 2.849	Mean: 115.316
------------	-----------	---------------

