

عنوان کنترل : کنترل I
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۵/۰۱

عنوان آزمایش : Troponin I
عنوان دستگاه : کوپاس E411
سری ساخت : ۶۵۷۶۷۸


| %CV | SD | SD ^{۳-} | SD ^{۲-} | SD ^{۱-} | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-------|-------|------------------|------------------|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۴,۸۰۹ | ۰,۰۳۸ | ۰,۶۷۸ | ۰,۷۱۶ | ۰,۷۵۴ | ۰,۷۹۲ | ۰,۸۳ | ۰,۸۶۸ | ۰,۹۰۶ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۰,۸۲۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۰,۸۲۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
| ۰,۷۶۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۰,۸۰۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
| ۰,۷۶۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |

| | | |
|------------|-----------|-------------|
| CV%: 3.708 | SD: 0.029 | Mean: 0.794 |
|------------|-----------|-------------|

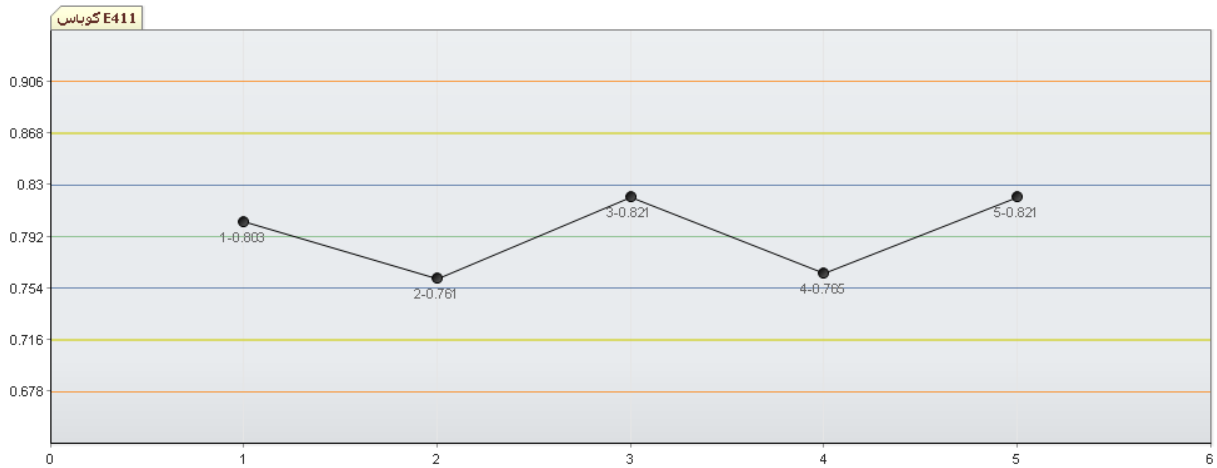

عنوان کنترل : abbot III
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۰۹

عنوان آزمایش : Troponin I
عنوان دستگاه : ABBOTT
سری ساخت : ۳۲۳۱۱۲۳۰

| %CV | SD | SD ^{۳-} | SD ^{۲-} | SD ^{۱-} | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-----|------|------------------|------------------|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۲,۸ | ۶۵,۵ | ۷۸۶ | ۸۵۱,۵ | ۹۱۷ | ۹۸۲,۵ | ۱۰۴۸ | ۱۱۱۳,۵ | ۱۱۷۹ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۹۳۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۹۶۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
| ۹۹۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ |
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
| ۹۸۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |

| | | |
|------------|------------|---------------|
| CV%: 4.062 | SD: 39.854 | Mean: 981.167 |
|------------|------------|---------------|

