

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

سری ساخت : GP N025

Alkaline Phosphatase : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :



%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۵۶۲	۲۷,۸۱۱	۳۴۰,۴۰۷	۳۶۸,۲۱۸	۳۹۶,۰۲۹	۴۲۳,۸۴	۴۵۱,۶۵۱	۴۷۹,۴۶۲	۵۰۷,۲۷۳

مقدار	تاریخ
۴۰.۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۳۹.۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۵
۴۰.۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۴۰.۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۴۱.۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۴۴.۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۴۲.۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۴۱.۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۴۴.۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۴۳.۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۴۲.۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۴۲.۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۴۱.۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۴۱.۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۸
۴۱.۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۴۵.۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۴۰.۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۴۰.۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۴۴.۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۴۲.۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۴۲.۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۴۲.۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۴۱.۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۴
۴۲.۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۴۵.۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۳۹.۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۴۵.۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۴۴.۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۴۴.۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۴۱.۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 4.157	SD: 17.6	Mean: 423.4
------------	----------	-------------

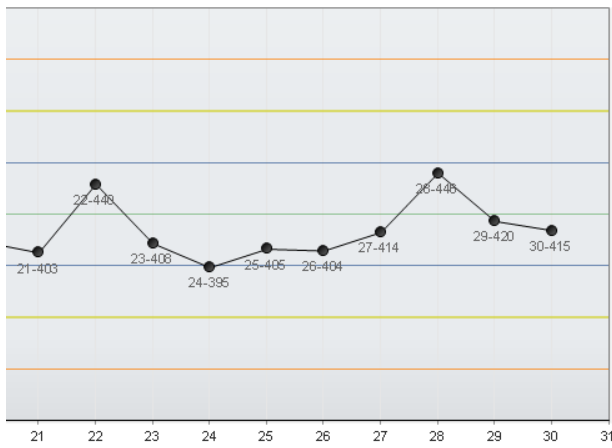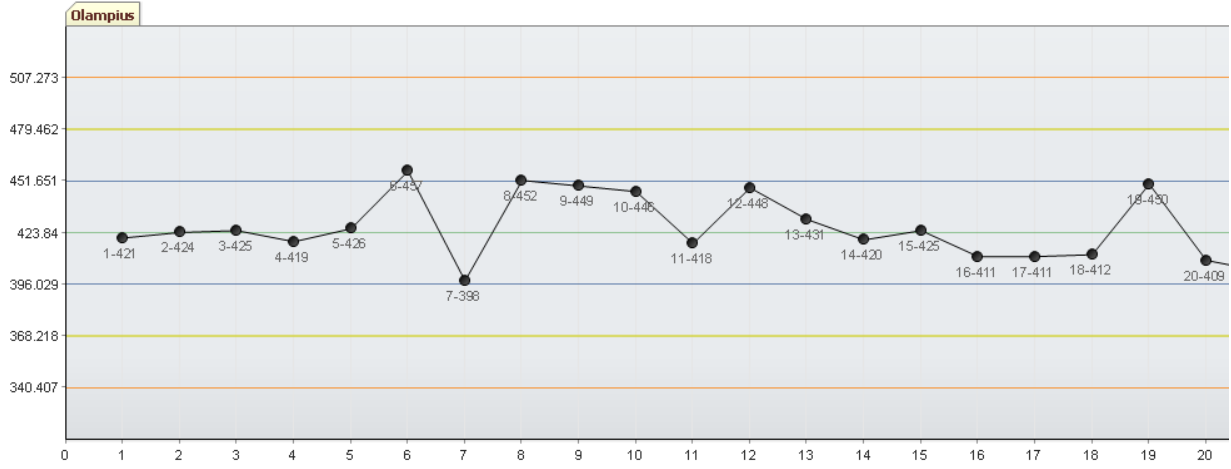

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

سری ساخت : GN625

Alkaline Phosphatase : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۹۶۴	۵,۲۳۸	۱۶۱,۰۴۶	۱۶۶,۲۸۴	۱۷۱,۵۲۲	۱۷۶,۷۶	۱۸۱,۹۹۸	۱۸۷,۲۳۶	۱۹۲,۴۷۴

مقدار	تاریخ
۱۷۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۱۷۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۵
۱۶۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۱۷۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۱۷۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۱۸۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۱۶۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۱۸۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۸۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۱۸۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۱۸۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۱۷۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۱۸۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۱۸۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۸
۱۸۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۱۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۱۷۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۱۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۱۷۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۸۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۱۸۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۱۸۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۱۷۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۴
۱۸۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۱۸۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۱۸۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۱۸۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۱۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۱۸۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۱۷۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 3.308	SD: 5.919	Mean: 178.933
------------	-----------	---------------

