

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

سری ساخت : GP N025

Amylase serum : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :



%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۳۰۱	۴,۱۸۸	۱۶۹,۴۷۶	۱۷۳,۶۶۴	۱۷۷,۸۵۲	۱۸۲,۰۴	۱۸۶,۲۲۸	۱۹۰,۴۱۶	۱۹۴,۶۰۴

مقدار	تاریخ
۱۷۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۱۷۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۵
۱۸۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۱۷۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۱۸۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۱۷۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۱۷۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۱۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۱۸۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۱۸۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۱۸۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۱۸۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۱۸۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۸
۱۸۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۱۸۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۱۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۱۸۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۱۸۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۷۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۱۷۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۱۸۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۱۷۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۴
۱۷۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۱۸۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۱۸۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۱۸۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۱۸۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۱۸۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۱۸۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 1.458	SD: 2.647	Mean: 181.6
------------	-----------	-------------

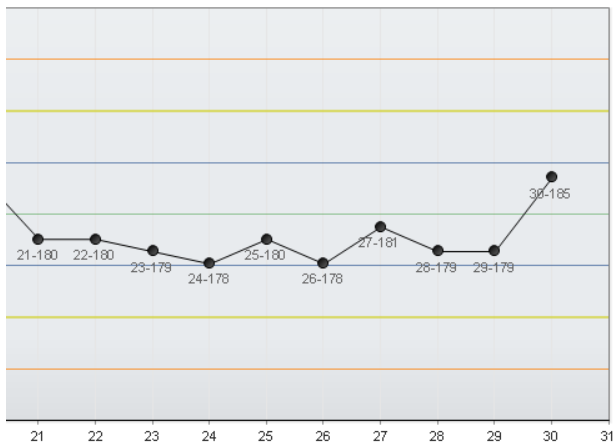

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

سری ساخت: GN625

Amylase serum : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۰۲۱	۰,۸۶۶	۸۲,۲۰۲	۸۳,۰۶۸	۸۳,۹۳۴	۸۴,۸	۸۵,۶۶۶	۸۶,۵۳۲	۸۷,۳۹۸

مقدار	تاریخ
۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۵
۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۸۴,۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۸۳,۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۸۶	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۸۶	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۸۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۸۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۸۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۸۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۸
۸۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۸۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۸۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۴
۸۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۸۳,۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۸۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۸۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۸۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۸۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 0.931	SD: 0.79	Mean: 84.817
------------	----------	--------------

