

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

Calcium : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP N025



%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۷۶۳	۰,۳۶۹	۱۲,۲۳۷	۱۲,۶۰۶	۱۲,۹۷۵	۱۳,۳۴۴	۱۳,۷۱۳	۱۴,۰۸۲	۱۴,۴۵۱

مقدار	تاریخ
۱۳,۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۱۳,۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۱۳,۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۱۳,۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۱۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۱۳,۶	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۳,۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۱۳,۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۱۳,۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۱۳,۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۱۳,۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۱۳,۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۸
۱۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۱۳,۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۱۳,۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۱۳,۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۱۳,۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۳,۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۱۳,۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۱۲,۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۴
۱۳,۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۱۳,۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۱۳,۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۱۳,۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۱۳,۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۱۳,۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۱۳,۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 2.247	SD: 0.302	Mean: 13.46
------------	-----------	-------------

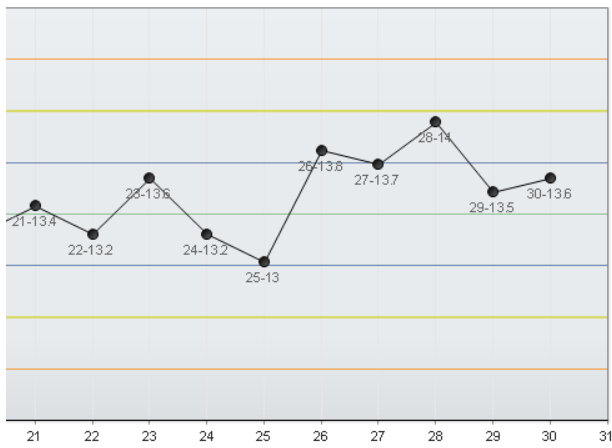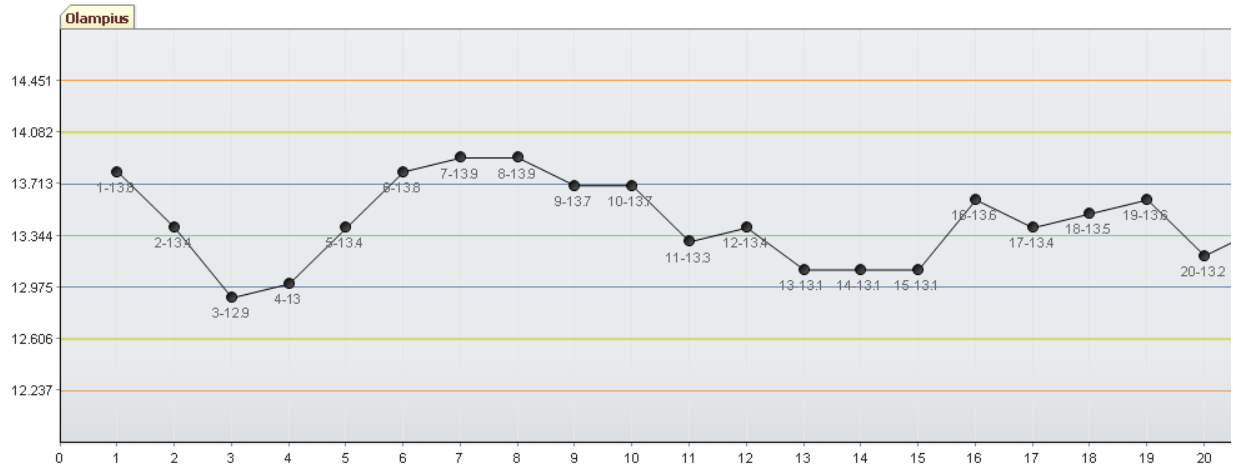

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

Calcium : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN625

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۲۴۸	۰,۱۱	۸,۴۷۴	۸,۵۸۴	۸,۶۹۴	۸,۸۰۴	۸,۹۱۴	۹,۰۲۴	۹,۱۳۴

مقدار	تاریخ
۸,۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۸,۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۵
۸,۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۸,۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۸,۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۸,۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۸,۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۸,۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۸,۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۸,۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۸,۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۸
۸,۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۸,۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۸,۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۸,۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۸,۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۸,۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۸,۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۸,۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۴
۸,۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۸,۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۸,۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۸,۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۸,۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۸,۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۸,۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 1.477	SD: 0.13	Mean: 8.78
------------	----------	------------

