

Control Hight : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

سری ساخت : GP N025

Direct bilirubin : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :



%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۶,۶۶	۰,۱۰۷	۱,۲۸۳	۱,۳۹	۱,۴۹۷	۱,۶۰۴	۱,۷۱۱	۱,۸۱۸	۱,۹۲۵

مقدار	تاریخ
۱,۷۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۱,۷۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۵
۱,۵۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۱,۷۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۱,۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۱,۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۱,۷۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۱,۶	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۱,۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۱,۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۱,۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۱,۷۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۱,۵۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۱,۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۸
۱,۷۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۱,۷۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۱,۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۱,۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۱,۷۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۱,۷۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۱,۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۱,۷۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۱,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۴
۱,۷۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۱,۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۱,۷۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۱,۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۱,۸۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۱,۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۱,۸۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 5.848	SD: 0.1	Mean: 1.709
------------	---------	-------------

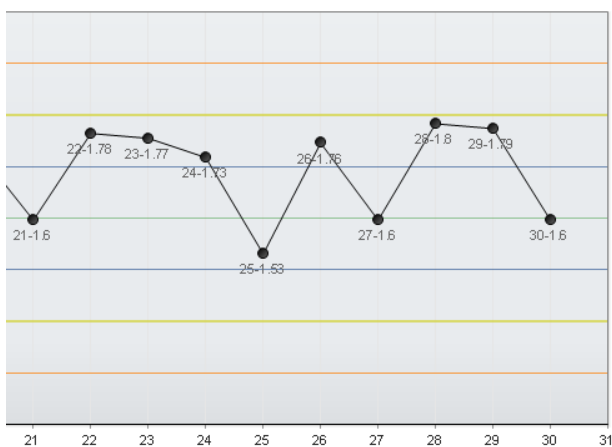

Control Normal : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

سری ساخت : GN625

Direct bilirubin : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۶۰۹	۰,۰۳۴	۰,۶۳۹	۰,۶۷۳	۰,۷۰۷	۰,۷۴۱	۰,۷۷۵	۰,۸۰۹	۰,۸۴۳

مقدار	تاریخ
۰,۷۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۰,۷۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۵
۰,۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۰,۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۰,۷۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۰,۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۰,۷۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۰,۷۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۰,۷۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۰,۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۰,۷۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۰,۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۰,۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۰,۷۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۸
۰,۷۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۰,۷۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۰,۷۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۰,۷۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۰,۷۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۰,۷۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۰,۷۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۰,۷۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۰,۷۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۴
۰,۷۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۰,۷۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۰,۷۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۰,۷۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۰,۷۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۰,۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۰,۷۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 3.702	SD: 0.028	Mean: 0.766
------------	-----------	-------------

