

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

Estradiol : عنوان آزمایش :
ABBOTT : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۲۳۱۱۲۳۰


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۴	۳,۹	۲۷,۳	۳۱,۲	۳۵,۱	۳۹	۴۲,۹	۴۶,۸	۵۰,۷

مقدار	تاریخ
۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۳
۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۳۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۳۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۹

مقدار	تاریخ
۴۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
۳۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۳۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۸

CV%: 8.554	SD: 3.385	Mean: 39.571
------------	-----------	--------------

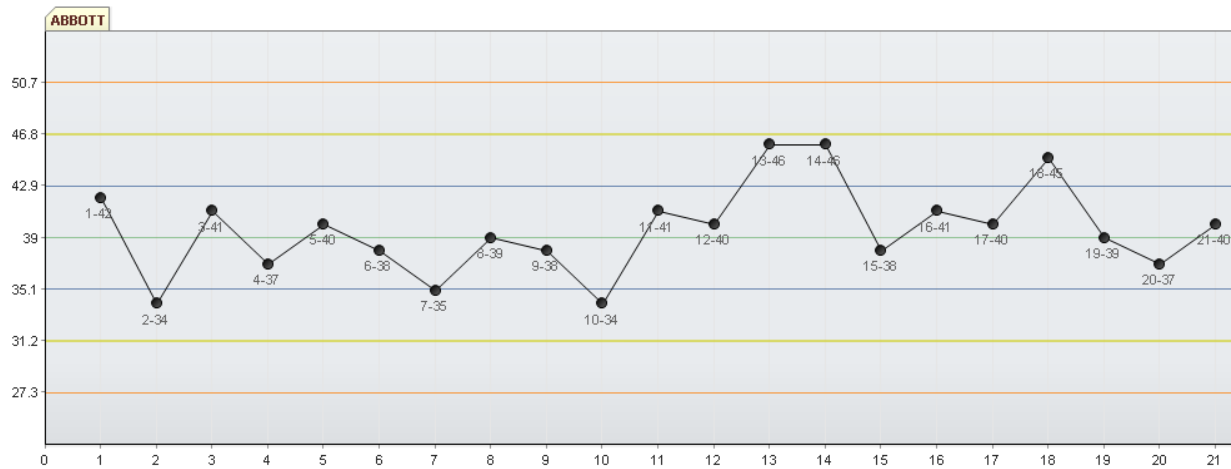

22