

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل : ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

عنوان آزمایش : FSH
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ۳۲۳۱۱۲۳۰


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۶	۰,۴۱۷	۴,۹۹۹	۵,۴۱۶	۵,۸۳۳	۶,۲۵	۶,۶۶۷	۷,۰۸۴	۷,۵۰۱

مقدار	تاریخ
۶,۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۶,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۳
۶,۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۶,۸	۱۴۰۵/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۶,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۶,۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۶,۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۶,۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۶,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۶,۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۶,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۹

مقدار	تاریخ
۶,۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
۶,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۶,۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۶,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۶,۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۶,۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۶,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۶,۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۸

CV%: 3.201	SD: 0.206	Mean: 6.438
------------	-----------	-------------

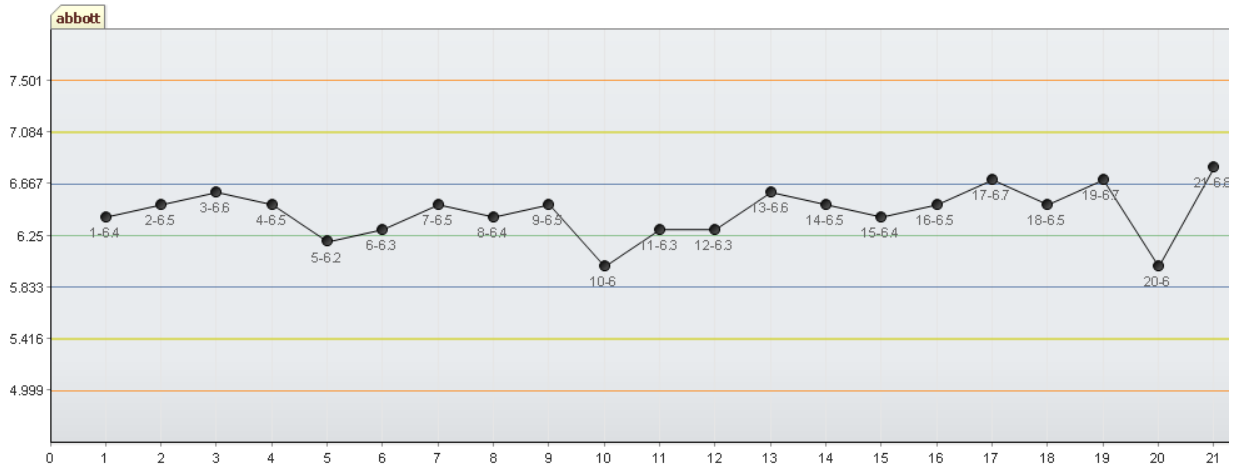

22