

Control Hight : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

سری ساخت : GP N025

Fasting Blood Sugar : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :



%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۵۰۹	۵,۷۸۱	۲۱۳,۰۹۷	۲۱۸,۸۷۸	۲۲۴,۶۵۹	۲۳۰,۴۴	۲۳۶,۲۲۱	۲۴۲,۰۰۲	۲۴۷,۷۸۳

مقدار	تاریخ
۲۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۲۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۵
۲۲۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۲۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۲۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۲۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۲۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۲۳۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۲۳۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۲۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۲۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۲۲۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۲۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۸
۲۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۲۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۲۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۲۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۲۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۲۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۲۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۲۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۲۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۴
۲۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۲۳۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۲۳۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۲۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۲۳۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۲۳۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۲۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 2.204	SD: 5.054	Mean: 229.333
------------	-----------	---------------

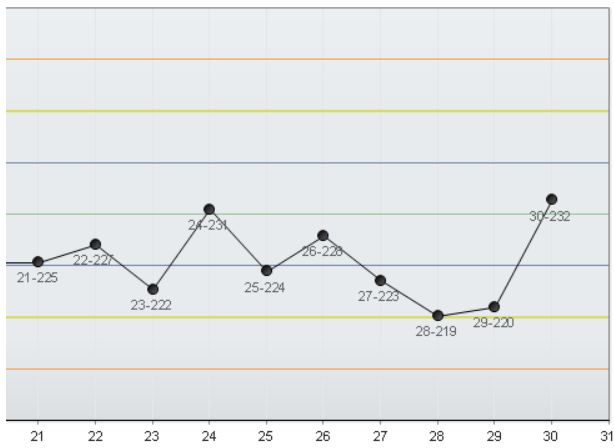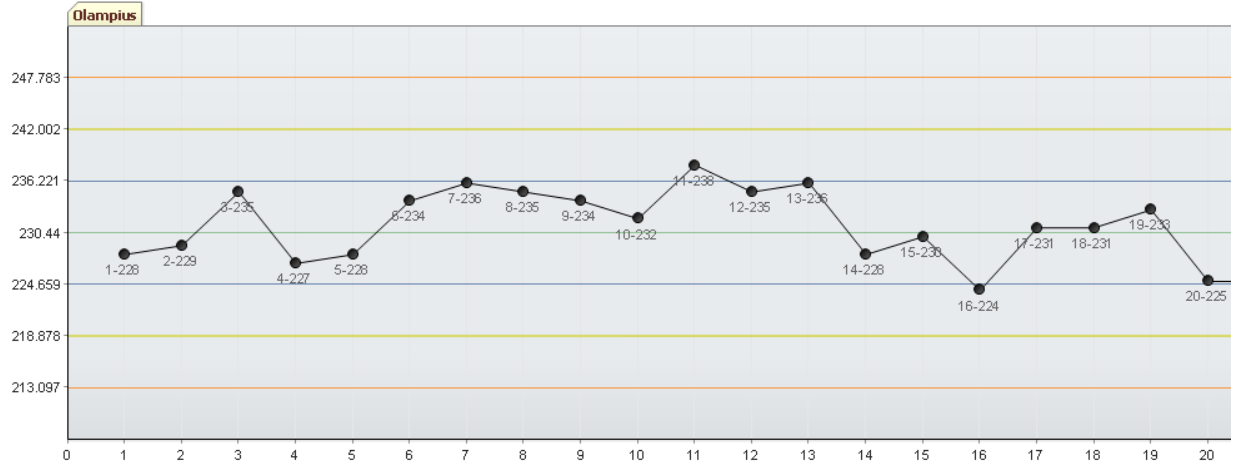

Control Normal : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

سری ساخت : GN625

Fasting Blood Sugar : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۲۱۴	۱,۲۹۴	۱۰۲,۶۷۸	۱۰۳,۹۷۲	۱۰۵,۲۶۶	۱۰۶,۵۶	۱۰۷,۸۵۴	۱۰۹,۱۴۸	۱۱۰,۴۴۲

مقدار	تاریخ
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۵
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۸
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۴
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 1.189	SD: 1.258	Mean: 105.733
------------	-----------	---------------

