

maternal control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۳/۰۳/۲۰:

MSA۱۴۴ : سری ساخت

(Estril (Free : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :



%CV	SD	SD _۲ -	SD _۲ -	SD _۱ -	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۲
۴,۷۲۴	۰,۰۲۶	۰,۴۷۷	۰,۵۰۳	۰,۵۲۹	۰,۵۵۵	۰,۵۸۱	۰,۶۰۷	۰,۶۳۳

مقدار	تاریخ
۰,۵۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۰,۵۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۰,۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۰,۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۰,۵۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۰,۵۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۰,۵۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۰,۵۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۰,۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۰,۵۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۰,۵۶۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۰,۵۳۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۰,۵۰۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۰,۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۰,۵۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۰,۵۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۰,۵۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۰,۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۰,۵۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۰,۵۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۰,۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۰,۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۳

CV%: 4.855	SD: 0.027	Mean: 0.561
------------	-----------	-------------

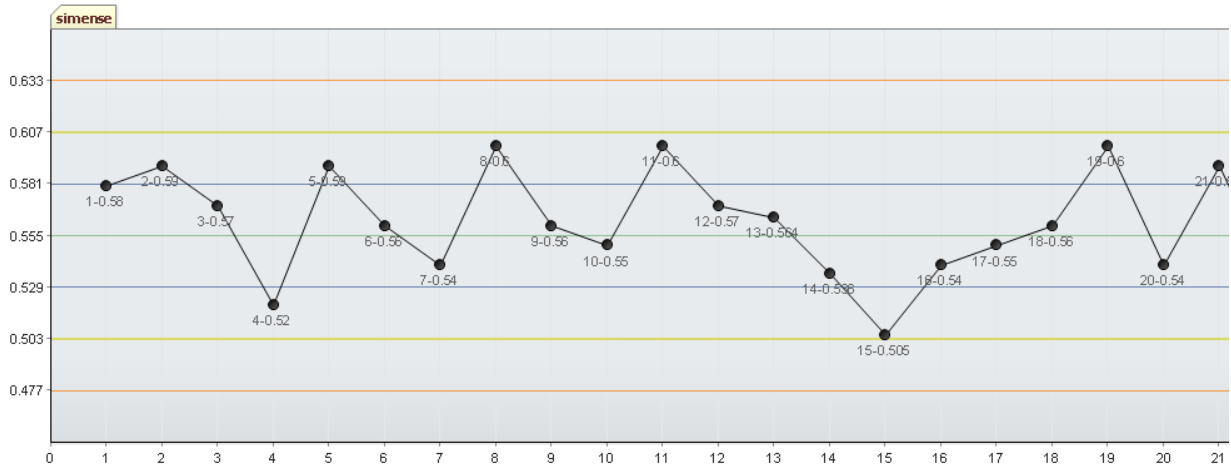

Randox III : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۵/۰۱/۰۸

(Estriol (Free : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :
سری ساخت : MS۸۱۵۴

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۵۹۴	۰,۲۵۸	۳,۸۳۷	۴,۰۹۵	۴,۳۵۳	۴,۶۱۱	۴,۸۶۹	۵,۱۲۷	۵,۳۸۵

مقدار	تاریخ
۴,۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۵,۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۴,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۴,۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۵,۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۵,۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۴,۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۴,۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۴,۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۴,۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۵,۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۴,۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۴,۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۴,۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۴,۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۴,۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۴,۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۴,۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۴,۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۴,۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۴,۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۴,۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۳

CV%: 6.054	SD: 0.285	Mean: 4.7
------------	-----------	-----------

