

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱

عنوان آزمایش : HBsAb
عنوان دستگاه : الایزایدر
سری ساخت : T17/7۱۲


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۱۴۷	۱,۱۵۹	۵۰,۵۰۳	۵۱,۶۶۲	۵۲,۸۲۱	۵۳,۹۸	۵۵,۱۳۹	۵۶,۲۹۸	۵۷,۴۵۷

مقدار	تاریخ
۵۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

مقدار	تاریخ
۵۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۵۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۵۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۸

مقدار	تاریخ
۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۵۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۵۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۵

CV%: 1.951	SD: 1.061	Mean: 54.375
------------	-----------	--------------

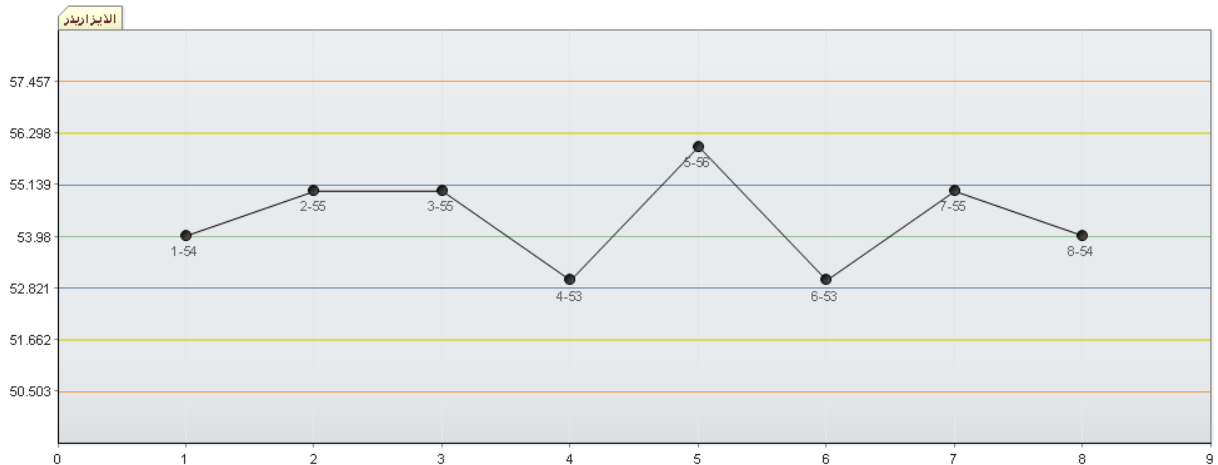

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت I
شروع کنترل: ۱۴۰۵/۰۲/۱۵

عنوان آزمایش : HBsAb
عنوان دستگاه : الیزاریدر
سری ساخت : P2-02001

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۳,۱	۳,۶۶۷	۱۶,۹۹۹	۲۰,۶۶۶	۲۴,۳۳۳	۲۸	۳۱,۶۶۷	۳۵,۳۳۴	۳۹,۰۰۱

مقدار	تاریخ
۲۷,۴	۱۴۰۵/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۹,۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۲۹,۴۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۳۰,۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۲۴,۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۹

مقدار	تاریخ
۲۸,۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۳۱,۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۲۵,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۲۶,۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۳

CV%: 8.374	SD: 2.358	Mean: 28.16
------------	-----------	-------------

