

abbott-1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سری ساخت : ۳۲۳۱۱۲۳۰

LH : عنوان آزمایش :

abbott : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۹	۰,۲۸۳	۳,۳۰۱	۳,۵۸۴	۳,۸۶۷	۴,۱۵	۴,۴۳۳	۴,۷۱۶	۴,۹۹۹

مقدار	تاریخ
۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۴,۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۳
۴,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۴,۴	۱۴۰۵/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۳,۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۴,۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۴,۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۴,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۹

مقدار	تاریخ
۴,۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
۳,۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۴,۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۴,۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۴,۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۴,۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۴,۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۸

CV%: 5.693	SD: 0.239	Mean: 4.19
------------	-----------	------------

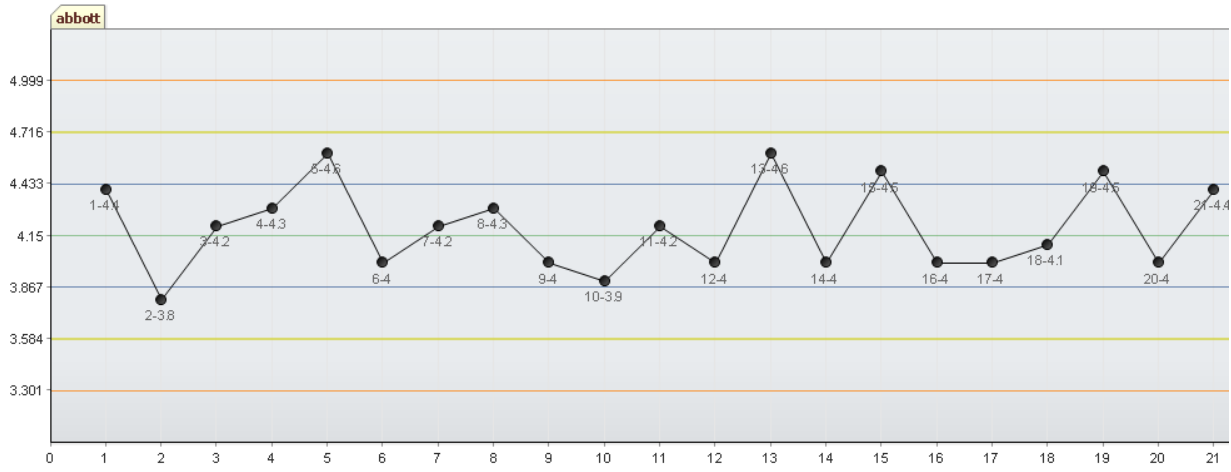

22