

Universal I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۱/۲۳

Progesterone : عنوان آزمایش :
کویاس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹



%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۴۵	۰,۳۵۸	۶,۹۶۶	۷,۳۲۴	۷,۶۸۲	۸,۰۴	۸,۳۹۸	۸,۷۵۶	۹,۱۱۴

مقدار	تاریخ
۸,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۸,۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۷,۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۸,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۸,۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۷,۶	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۷,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۸,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۸,۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۷,۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۸,۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۷,۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۸,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۸,۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۸,۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۷,۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۷,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۸,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۸,۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۸,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۸,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 4.469	SD: 0.364	Mean: 8.148
------------	-----------	-------------

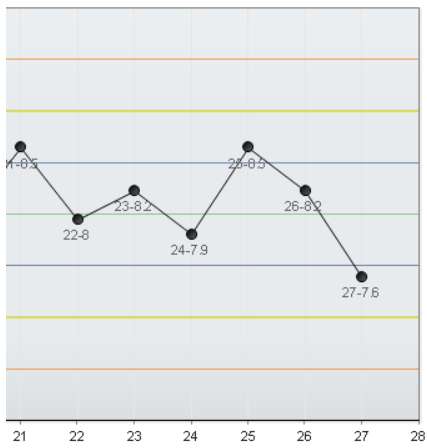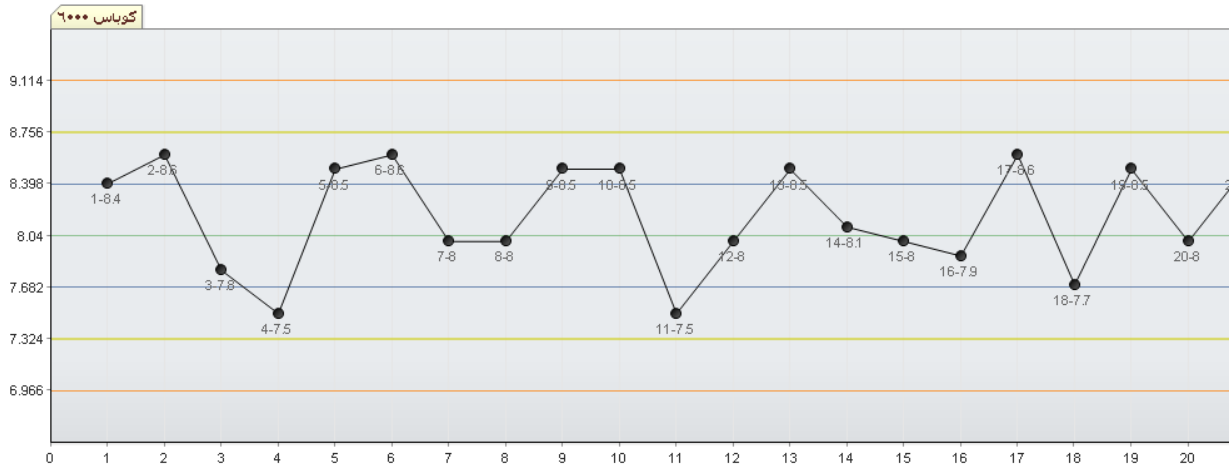

عنوان کنترل : Universal II
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۱/۲۳

عنوان آزمایش : Progesterone
عنوان دستگاه : کویاس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۶۲۳	۱,۱۳۷	۱۶,۸۱۶	۱۷,۹۵۳	۱۹,۰۹	۲۰,۲۲۷	۲۱,۳۶۴	۲۲,۵۰۱	۲۳,۶۳۸

مقدار	تاریخ
۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۲۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۲۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۲۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۲۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۲۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۱۸,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۲۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۹,۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۲۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۲۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۲۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۲۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۰

CV%: 5.003	SD: 1.022	Mean: 20.432
------------	-----------	--------------

