

عنوان آزمایش : (Total Thyroxine (T4
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹
عنوان کنترل : Universal I
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۵/۰۱


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۲۶۲	۰,۱۶۸	۶,۹۲۳	۷,۰۹۱	۷,۲۵۹	۷,۴۲۷	۷,۵۹۵	۷,۷۶۳	۷,۹۳۱

مقدار	تاریخ
۷,۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۷,۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۷,۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۷,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۷,۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۷,۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۷,۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۷,۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۷,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۷,۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۷,۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۷,۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۷,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۷,۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۸

CV%: 1.947	SD: 0.144	Mean: 7.393
------------	-----------	-------------

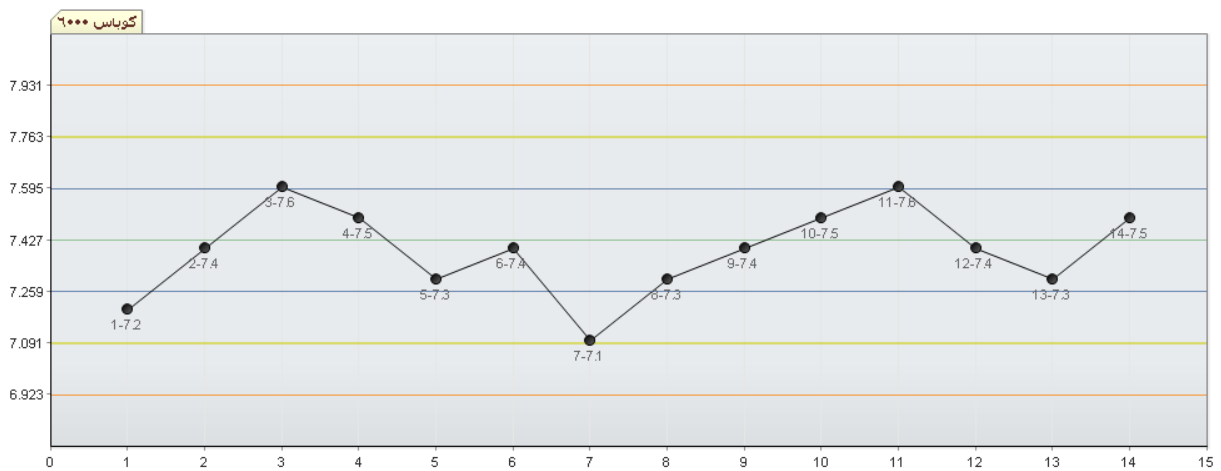

عنوان آزمایش : (Total Thyroxine (T4
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
عنوان کنترل : Universal II
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۵/۰۱
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۸۸۸	۰,۳۲۸	۱۰,۳۶۶	۱۰,۶۹۴	۱۱,۰۲۲	۱۱,۳۵	۱۱,۶۷۸	۱۲,۰۰۶	۱۲,۳۳۴

مقدار	تاریخ
۱۱,۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۱۱,۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۱۱,۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۱۱,۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۱,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۱۱,۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۱۱,۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۱۱,۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۱۱,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۱۱,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۱۱,۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۱۱,۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۱۱,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۱۱,۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۸

CV%: 1.701	SD: 0.194	Mean: 11.407
------------	-----------	--------------

