

عنوان کنترل : Universal I
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۷/۱۹

عنوان آزمایش : TSH
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹-


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۴۷۱	۰,۰۳۵	۱,۳۱۵	۱,۳۳۵	۱,۳۸۵	۱,۴۲	۱,۴۵۵	۱,۴۹	۱,۵۲۵

مقدار	تاریخ
۱,۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۱,۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۱,۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۱,۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۱,۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۱,۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۱,۴۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۱,۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۱,۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۱,۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۱,۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۱,۴۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۱,۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۱,۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۸

CV%: 1.94	SD: 0.028	Mean: 1.418
-----------	-----------	-------------

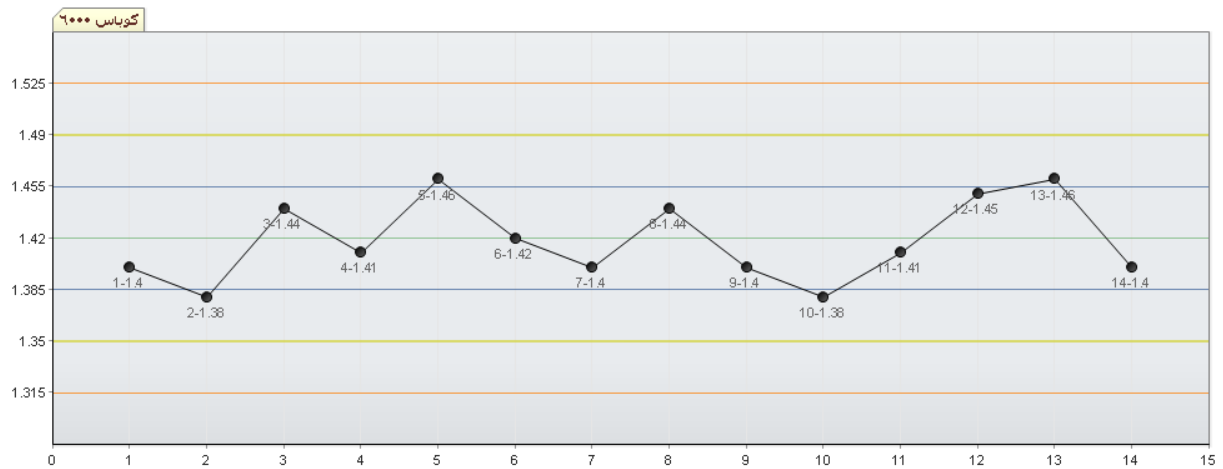

عنوان کنترل : Universal II
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۷/۱۹

عنوان آزمایش : TSH
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۹۳۴	۰,۲۷۱	۸,۴۳۴	۸,۷۰۵	۸,۹۷۶	۹,۲۴۷	۹,۵۱۸	۹,۷۸۹	۱۰,۰۶

مقدار	تاریخ
۹,۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۹,۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۹,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۹,۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۹,۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۹,۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۹,۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۸,۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۸,۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۸,۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۹,۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۹,۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۹,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۸

CV%: 2.808	SD: 0.258	Mean: 9.179
------------	-----------	-------------

