

ABBOTT-2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سری ساخت : ۳۲۳۱۱۲۳۰

Testosterone : عنوان آزمایش :
abbott : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۸	۲۶,۱۶۷	۳۱۱,۹۹۹	۳۳۸,۱۶۶	۳۶۴,۳۳۳	۳۹۰,۵	۴۱۶,۶۶۷	۴۴۲,۸۳۴	۴۶۹,۰۰۱

مقدار	تاریخ
۴۱۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۴۰۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۴۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۳۶۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۳۹۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۳۵۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۳۶۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۳۷۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۳۹۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۴۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۴۱۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۴۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۴۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰

مقدار	تاریخ
۴۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
۴۱۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۴۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۳۹۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۳۹۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۳۸۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۳۸۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۴۱۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۸

CV%: 5.459	SD: 21.784	Mean: 399.048
------------	------------	---------------

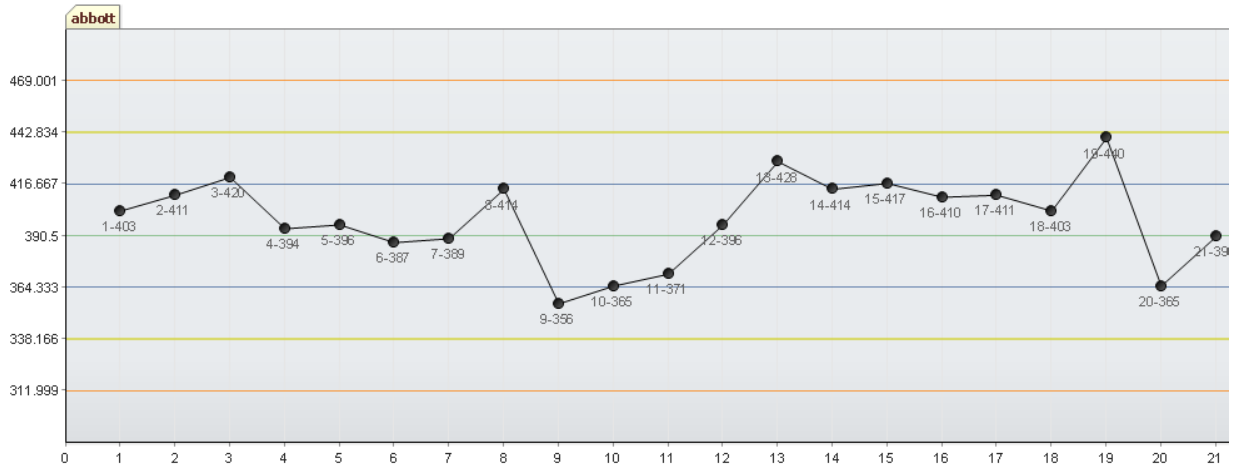

22